

Fakkeltog

I år afholdes fakkeltog til minde om mennesker, der er døde af AIDS, søndag den 19. maj.

I København begynder fakkeltog kl. 22.00 på Frue Plads, og det afsluttes samme sted. Der kan købes fakler på pladsen.

Talere er i år forfatteren Benny Andersen, overlæge Johan Wandall fra Frederiksberg Hospital og Jannie Petersen, som er HIV-smittet.

Den musikalske underholdning står Søs Fenger for. Efter Fakkeltog er der gudstjeneste i Domkirken v. Ivan Larsen og Anette Brønnum.

Praktiske spørgsmål om arrangementet kan rettes til Stop Aids Kampagnen, tlf.: 33 11 29 11.

I Odense begynder fakkeltog kl. 20.15 på Sct. Anne Plads. Efter velkomst v. Poul Madsen fremfører skuespilleren Kim Harris en prolog. Der vil også være taler af Viceamtsborgmester Jan Boye og Bo Johansen fra brugergruppen.

Undervejs i arrangementet er der musikalske indslag fra Anne Herdorf akkompagneret af Sune Kempf og Gry Trampedach akkompagneret af Nis P. og Stanley.

Faklerne tændes kl. 22.00, og kl. 23.00 er der andagt i Domkirken v. sognepræst Egon Lausen. Organist er Freddy Samsing. Koret "aldrig otte" synger ved gudstjenesten.

Yderligere oplysninger kan fås hos AIDS-INFO Fyn, tlf. 65 91 11 19.

I Århus begynder fakkeltog kl. 21.30 på Store Torv med taler og musik. Derefter tændes faklerne og deltagerne begiver sig ud på ruten.

Kl. 22.50 vender optoget tilbage til Store Torv, og kl. 23.15 er der en kort mindehøjtidelighed i domkirken.

Yderligere oplysninger kan fås hos AktHIV-Huset, tlf. 86 18 16 46.

I Esbjerg begynder fakkeltog kl. 19.00 på torvet. Skoleinspektør Else Møller Jensen og Anders Røge taler. Der vil være musikalske indslag med blandt andet "U2 project". Kl. 21.45 tændes faklerne og optoget begiver sig ud på ruten. Arrangementet afsluttes med gudstjeneste v. Arne Aae i Vor Frelser Kirke.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ribe Amts AIDS-Sekretariatet, tlf. 75 12 15 74.

Abbott HIV-test

3. april udsendte Sundhedstilsynet en pressemeddelelse, hvori det blev meddelt, at en 3. generations HIV-test fra firmaet Abbott (IMx plus) i fire tilfælde på verdensplan ikke havde været pålidelig til påvisning af antistoffer mod HIV.

Statens Seruminstitut har gennem de seneste 5 år løbende overvåget de HIV-tests, der anvendes på danske laboratorier.

Systemet fungerer sådan, at Seruminstitutet sender prøver til laboratorierne med forskellig mængde af antistof, prøver der er falsk positive og sande positive prøver. Herefter tester laboratorierne prøverne, oplyser hvilke testkits, de anvender og hvilke resultater, de har fået. Laboratorierne rapporterer også, hvor mange analyser de har foretaget de seneste seks måneder, og hvor mange positive og falske positive prøver, der er fundet.

På den måde er det muligt at afsløre, om der er alvorlige fejl ved en HIV-test, samtidig med at det kan vurderes om laboratorierne håndterer testkittet på en tilfredsstillende måde.

De laboratorier, der indgår i ordningen, lever op til kravene.

For yderligere at styrke kontrollen af HIV-testkits kvalitet har Sundhedsstyrelsen taget initiativ til, at Statens Seruminstitut på vegne af Sundhedsstyrelsen foretager en medicinsk teknologivurdering af testkittene.

Ordningen indebærer følgende:

- de tests, der allerede er vurderet på Statens Seruminstitut samt har indgået i allerede foretagne evalueringer med laboratorierne, anbefales til fortsat anvendelse.

- at tests, som ikke allerede er vurderet i samarbejdet mellem Statens Seruminstitut og laboratorierne vurderes.

- den kvalitetskontrol, som løbende foretages på Statens Seruminstitut, skal forsøges udvidet til at omfatte alle laboratorier, som foretager HIV-tests.

Denne procedure skulle sikre den bedst mulige sikkerhed i forbindelse med kontrol af screenings-testen.

Alle prøver, der i Danmark findes positive for



200008047927

HIV-antistof med en screeningsmetode, bliver opfølgende undersøgt med en supplerende metode (konfirmatorisk test). For også at kvalitetssikre den konfirmatoriske test, har Sundhedsstyrelsen anmodet de laboratorier, der foretager konfirmatoriske tests, om at indgå i et formaliseret samarbejde med Statens Seruminstitut.

Blodtransfusioner



Bl.a. på baggrund af tilbagetrækningen af Abbott-testen, er der opstået en del bekymring m.h.t. risikoen ved at modtage blod i forbindelse med operationer.

Risikoen for at blive smittet med HIV gennem én portion blod er i Danmark 0,00055%.

Det tal er Sundhedsstyrelsen nået frem til på følgende måde: De seneste fem år er der på landsplan fundet 11 HIV-positive bloddonorer blandt de 2 millioner portioner blod, der er tappet i perioden. Sandsynligheden for HIV-positivitet ved én enkelt blodtransfusion på landsplan er derfor 5,5:1.000.000, hvilket svarer til 0,00055%. Sandsynligheden for at overse én portion HIV-positivt blod screenet med ovennævnte Abbott-test er skønsmæssigt 0,000055%. Dette tal er fremkommet ved at antage at falsk-negativ raten ved testen er 1%, hvilket er meget højt sat. Konklusionen er derfor, at der eksisterer en yderst minimal risiko for overførsel af HIV-smitte ved blodtransfusioner i Danmark.

Anmeldte AIDS-tilfælde i Danmark


1980 - 30. April 1996. Antal i alt: 1883

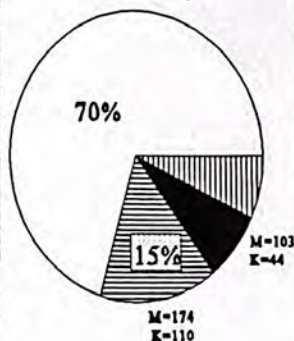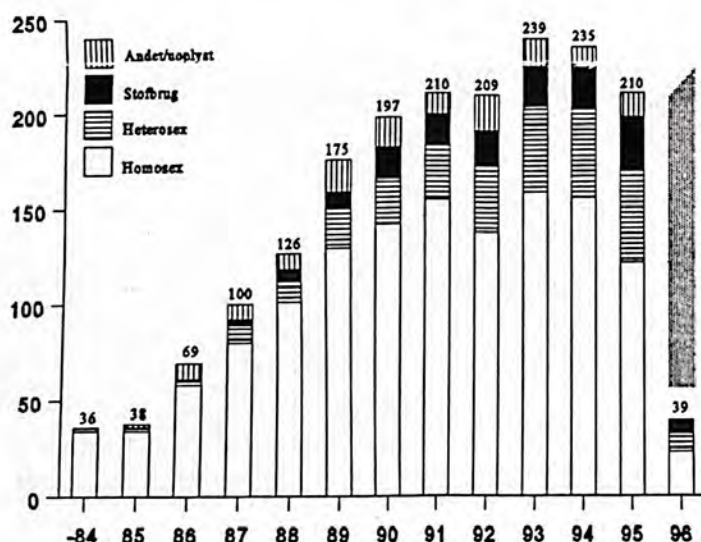

Nyfundne HIV-positive

August 1990 - 30. April 1996

Antal i alt: 1833

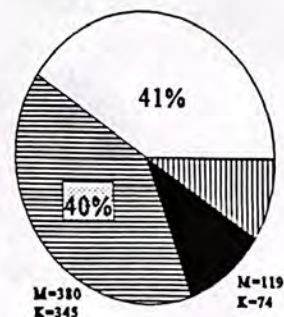

AIDS-statistikken dækker samtlige AIDS-tilfælde siden 1980, mens HIV-meldesystemet kun omfatter dem, der har valgt at lade sig teste siden 1990. De nyeste tal er reelt større end angivet, da nogle tilfælde erfaringsmæssigt indberettes noget senere, end de opdaget.